

Disinfektan dan Larutan Pembersih untuk Sistem Ultrasound dan Transduser

Daftar Isi

1	Baca Ini Terlebih Dahulu.....	5
	Simbol Peringatan.....	7
	Komentar Pelanggan.....	8
	Layanan Pelanggan.....	8
	Ketentuan Informasi Pengguna.....	9
2	Keselamatan.....	11
	Peringatan dan Perhatian.....	11
	Pemaparan Glutaraldehyd.....	14
3	Disinfektan dan Larutan Pembersih.....	15
	Disinfektan dan Pembersih untuk Permukaan Sistem.....	15
	Panduan untuk AR (Reprosesor Otomatis/Automated Reprocessors).....	18
	Panduan untuk AER (Automated Endoscope Reprocessors/Reprosesor Endoskopi Otomatis).....	20
	Disinfektan dan Larutan Pembersih untuk Transduser.....	21
	Kompatibilitas Disinfektan menurut Nama Transduser.....	22
	Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan.....	27
	Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel.....	31

1 Baca Ini Terlebih Dahulu

Informasi pengguna untuk produk Philips Anda berisi penjelasan lengkap mengenai konfigurasi produk dengan jumlah opsi dan aksesori yang maksimum. Beberapa fungsi yang dijelaskan mungkin tidak tersedia pada konfigurasi produk Anda.

Transduser hanya tersedia di negara atau wilayah yang menyetujuinya. Untuk informasi khusus wilayah Anda, hubungi perwakilan Philips setempat.

Panduan ini mencantumkan disinfektan dan larutan pembersih yang kompatibel dengan sistem ultrasound dan transduser Philips milik Anda. Informasi di panduan ini berlaku untuk sistem ultrasound berikut:

- Seri Affiniti
- Seri ClearVue
- CX30
- CX50
- Seri EPIQ
- HD5
- HD6
- HD7
- Seri HD11
- HD15
- iE33
- iU22
- Lumify
- Sparq
- Xperius (didistribusikan oleh B.Braun)

Untuk informasi tentang sistem ultrasound atau transduser Philips yang tidak disebutkan secara spesifik dalam dokumen ini, lihat *Panduan Pengguna* sistem Anda yang menyediakan informasi khusus untuk sistem dan transduser Anda.

Selalu ikuti petunjuk produsen saat menggunakan disinfektan dan larutan pembersih.

Karena banyak sekali produk pembersih dan disinfeksi yang tersedia, tidak mungkin untuk mencantumkan semuanya di dalam tabel. Jika Anda tidak yakin bahwa suatu produk sesuai untuk digunakan, harap hubungi perwakilan Philips untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Untuk petunjuk tentang pembersihan dan desinfeksi sistem ultrasound dan transduser, lihat bagian *Pemeliharaan dan Pembersihan Sistem Ultrasound dan Transduser* (yang tersedia dalam dokumentasi sistem Anda) atau situs web "Transducer and System Care":

www.philips.com/transducercare

Untuk daftar transduser yang didukung oleh sistem Anda, lihat *Panduan Pengguna* sistem Anda, yang menyediakan informasi yang sesuai dengan sistem dan transduser Anda.

Untuk informasi lebih lanjut:

- Di Amerika Utara, hubungi Philips di 800-722-9377.
- Di luar Amerika Utara, hubungi perwakilan Philips setempat.
- Kunjungi laman situs "Transducer and System Care":

www.philips.com/transducercare

Dokumen dan informasi yang terkandung di dalamnya merupakan informasi rahasia dan milik dari Philips dan tidak dapat dicetak ulang, disalin baik keseluruhan maupun sebagian, diadaptasi, dimodifikasi, diungkapkan kepada pihak lain, atau disebarluaskan tanpa izin tertulis sebelumnya dari Philips Legal Department. Dokumen ini ditujukan untuk digunakan oleh pelanggan dan dilisensikan kepada pelanggan sebagai bagian dari pembelian peralatan Philips, atau untuk memenuhi kesesuaian peraturan sebagaimana disyaratkan oleh FDA dalam bagian 21 CFR 1020.30 (dan setiap amandemen daripadanya) dan persyaratan peraturan setempat lainnya. Orang yang tidak berkompoten dilarang keras menggunakan dokumen ini.

Philips memberikan dokumen ini tanpa jaminan apa pun, baik tersirat maupun tersurat, termasuk namun tidak terbatas pada jaminan tersirat atas kelayakan untuk diperdagangkan, dan kesesuaian untuk tujuan tertentu.

Philips telah memastikan keakuratan dokumen ini. Namun demikian, Philips tidak memiliki tanggung jawab atas kesalahan atau penghilangan, dan berhak melakukan perubahan pada produk apa pun yang disebutkan di sini tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk menyempurnakan keandalan, fungsi, atau desain. Philips dapat melakukan penyempurnaan atau perubahan pada produk atau program yang dijelaskan dalam dokumen ini setiap saat.

Penyalinan dokumen ini tanpa izin tertulis, selain melanggar hak cipta, dapat mengurangi kemampuan Philips untuk memberikan informasi yang akurat dan aktual kepada pengguna.

"xMATRIX" adalah merek dagang dari Koninklijke Philips N.V.

Nama produk yang bukan Philips mungkin merupakan merek dagang dari pemilik yang bersangkutan.

Simbol Peringatan

Berikut adalah simbol peringatan yang mungkin digunakan pada sistem. Untuk simbol tambahan yang digunakan pada sistem, lihat bagian "Keamanan" dalam *Panduan Pengguna* sistem Anda.

Simbol Peringatan

Simbol	Deskripsi
	Menunjukkan pesan keselamatan.
	Tegangan berbahaya: Muncul di samping terminal tegangan tinggi, mengindikasikan adanya tegangan yang lebih besar dari 1.000 Vac (600 Vac di Amerika Serikat).

Simbol	Deskripsi
	Menunjukkan sensitivitas ESD (pelepasan listrik statis) dari konektor yang tidak diuji sebagaimana ditentukan dalam IEC 60601-1-2. Jangan sentuh pin konektor yang terbuka. Menyentuh pin yang terbuka dapat menyebabkan pelepasan listrik statis yang dapat merusak produk.
	Menunjukkan bahwa pengguna harus melihat petunjuk penggunaan untuk informasi keselamatan.

Komentar Pelanggan

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang informasi pengguna atau menemukan kesalahan dalam informasi pengguna, untuk wilayah Amerika Serikat silakan hubungi Philips di 800-722-9377; sedangkan untuk wilayah di luar Amerika Serikat silakan hubungi perwakilan layanan pelanggan Philips setempat.

Layanan Pelanggan

Perwakilan layanan pelanggan tersedia secara global untuk menjawab pertanyaan serta memberikan pemeliharaan dan layanan kepada pelanggan. Silakan hubungi perwakilan Philips di kota Anda untuk bantuan. Anda juga dapat menghubungi kantor operasional berikut untuk mendapatkan arahan ke perwakilan layanan pelanggan atau kunjungi situs web "Hubungi Kami" ini:

www.healthcare.philips.com/main/about/officelocator/index.wpd

Philips Ultrasound, Inc.

22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431, USA

800-722-9377

Ketentuan Informasi Pengguna

Informasi pengguna untuk produk Anda menggunakan kaidah penulisan untuk membantu menemukan dan memahami informasi sebagai berikut:

- Semua prosedur diberi nomor dan subprosedur diberi huruf. Anda harus melakukan langkah demi langkah sesuai urutan yang disajikan agar berhasil.
- Daftar dengan simbol menunjukkan informasi umum tentang fungsi atau prosedur tertentu, bukan prosedur berurutan.
- Sisi kiri sistem adalah sebelah kiri Anda bila Anda berdiri di depan sistem, menghadap sistem. Sisi depan sistem adalah area yang terdekat dengan Anda saat mengoperasikannya.
- Transduser dan probe pensil mengacu pada transduser, kecuali jika perbedaan diperlukan untuk mendukung makna teks.

Informasi penting untuk penggunaan produk yang aman dan efektif diberikan dalam informasi pengguna sebagai berikut:



PERINGATAN

Peringatan menekankan informasi penting untuk keselamatan Anda, operator, dan pasien.



PERHATIAN

Perhatian menjelaskan berbagai tindakan yang dapat merusak produk dan akibatnya membatalkan garansi atau kontrak servis Anda atau tindakan apa pun yang mengakibatkan terhapusnya data pasien atau sistem.

CATATAN

Catatan mengalihkan perhatian Anda ke informasi penting yang akan membantu Anda mengoperasikan produk secara lebih efektif.

2 Keselamatan

Baca informasi yang disertakan pada bagian ini untuk memastikan keselamatan orang yang mengoperasikan dan memelihara peralatan ultrasound, semua pasien yang menjalani pemeriksaan, dan untuk memastikan kualitas sistem serta aksesorinya.

Peringatan dan Perhatian

Ketika menggunakan pembersih dan disinfektan, cermati peringatan dan perhatian berikut:



PERINGATAN

Tidak semua disinfektan berfungsi secara efektif terhadap semua jenis kontaminasi. Pastikan bahwa jenis disinfektan sesuai untuk sistem atau transduser yang ditentukan dan kapasitas larutan serta durasi kontak sesuai untuk tujuan penggunaan klinis.



PERINGATAN

Disinfektan direkomendasikan karena kompatibilitas kimianya dengan material produk, bukan keefektifan biologisnya. Untuk efektivitas biologis suatu disinfektan, lihat panduan dan rekomendasi dari produsen disinfektan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat, dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat.



PERINGATAN

Jika larutan pracampur digunakan, pastikan Anda memperhatikan tanggal kedaluwarsa larutan tersebut.

**PERINGATAN**

Tingkat disinfektan yang diperlukan untuk perangkat ditentukan berdasarkan jenis jaringan yang akan mengalami kontak selama penggunaan. Pastikan jenis disinfektan telah sesuai dengan jenis transduser dan aplikasi transduser. Untuk informasi mengenai ketentuan tingkat desinfeksi, lihat panduan *Pemeliharaan dan Pembersihan Sistem Ultrasound dan Transduser* atau situs web "Transducer and System Care" (www.philips.com/transducercare). Untuk informasi lebih lanjut, lihat petunjuk label disinfektan dan saran Association for Professionals in Infection Control, U.S. Food and Drug Administration, serta U.S. Centers for Disease Control.

**PERINGATAN**

Selalu gunakan pelindung mata dan sarung tangan saat membersihkan, mendesinfeksi, atau mensterilkan peralatan apa pun.

**PERHATIAN**

Menggunakan disinfektan yang tidak disarankan, menggunakan kekuatan larutan yang tidak sesuai, atau mencelupkan transduser lebih dalam maupun lebih lama dari yang disarankan dapat merusak atau mengubah warna transduser dan membatalkan jaminan transduser.

**PERHATIAN**

Penggunaan isopropil alkohol (alkohol gosok), denaturasi etil alkohol, dan produk berbahan dasar alkohol pada semua transduser dibatasi. Pada transduser dengan konektor USB, bagian yang boleh dibersihkan dengan alkohol hanyalah rumah dan lensa (jendela akustik) transduser. Pada transduser non-TEE, bagian yang boleh dibersihkan dengan alkohol hanyalah rumah konektor dan rumah transduser dan lensa. Pada transduser TEE, bagian yang dapat dibersihkan dengan alkohol hanyalah rumah konektor dan rumah kontrol. Pastikan larutan hanya isopropil alkohol 91% atau kurang, atau denaturasi etil alkohol 85% atau kurang. Jangan bersihkan bagian lain dari transduser dengan alkohol (termasuk kabel, konektor USB, atau pelepas tegangan), karena dapat merusak bagian transduser tersebut. Kerusakan ini tidak tercakup dalam jaminan atau kontrak layanan Anda.

**PERHATIAN**

Beberapa produk pembersih dan disinfektan mungkin mengakibatkan kelunturan jika residu disinfektan dan gel belum benar-benar dibersihkan setelah setiap penggunaan. Selalu bersihkan gel sepenuhnya sebelum menggunakan pembersih dan disinfektan. Jika perlu, dan kompatibel untuk digunakan, isopropil alkohol 70% dapat dipakai untuk membersihkan residu yang menumpuk pada komponen sistem. Jika perlu, dan kompatibel untuk digunakan, larutan isopropil alkohol 91% atau kurang atau larutan denaturasi etil alkohol 85% atau kurang dapat dipakai untuk membersihkan residu yang menumpuk pada beberapa komponen transduser.

**PERHATIAN**

Jangan memasang film adesif, seperti Tegaderm, ke lensa transduser. Pemasangan film semacam itu dapat merusak lensa.

Pemaparan Glutaraldehid

OSHA (Occupational Safety and Health Administration) Amerika Serikat telah mengeluarkan peraturan yang mencakup tingkat pemaparan glutaraldehid yang dapat diterima di lingkungan kerja. Philips tidak menjual disinfektan berbasis glutaraldehid bersama dengan produknya, namun jenis disinfektan ini disarankan untuk desinfeksi transduser yang digunakan dalam prosedur TEE, intraoperatif, endokavitas, pemandu jarum, dan biopsi.

Untuk mengurangi munculnya asap glutaraldehid di udara, pastikan Anda menggunakan wadah rendaman yang tertutup atau berventilasi. Sistem tersebut dijual terpisah. Informasi terkini tentang produk desinfeksi dan transduser Philips dapat ditemukan di situs web "Transducer and System Care" Philips:

www.philips.com/transducercare

3 Disinfektan dan Larutan Pembersih

Topik berikut ini mencantumkan disinfektan dan larutan pembersih yang kompatibel dengan sistem ultrasound dan transduser Philips milik Anda.

Disinfektan dan Pembersih untuk Permukaan Sistem

Kompatibilitas dari larutan pembersih dan disinfektan beragam bergantung pada item yang digunakan.

Sistem Lumify

Merupakan tanggung jawab Anda untuk membersihkan dan melakukan desinfeksi perangkat dengan benar sesuai dengan instruksi dari produsen perangkat dan kebijakan lembaga Anda untuk membersihkan serta melakukan desinfeksi perangkat medis.

Semua Sistem Kecuali Lumify

Produk pada tabel di bawah ini kompatibel pada permukaan sistem berikut:

- Kabel, sadapan, dan elektroda batang EKG
- Permukaan plastik dan cat eksternal pada sistem dan kereta
- Panel kontrol sistem
- Layar sentuh dan layar monitor
- Pengelola kabel transduser yang mudah dijepit
- Panel kontrol sistem

Larutan Pembersih untuk Segala Permukaan	Larutan Pembersih untuk Layar Sentuh dan Layar Monitor	Disinfektan untuk Permukaan Sistem dan Layar Sentuh
Larutan sabun lembut ¹	<ul style="list-style-type: none"> Larutan sabun lembut¹ Pembersih yang dirancang untuk LCD atau OLED Air yang dimurnikan 	<ul style="list-style-type: none"> Isopropil alkohol (IPA) 70% Opti-Cide3 (berbahan dasar QUAT/IPA) Oxivir Tb (berbahan dasar hidrogen peroksida terakselerasi) PI-Spray II (berbahan dasar QUAT) Penyemprot atau penyeka protex (hanya kompatibel dengan sistem seri EPIQ, Affiniti, dan Xperius) Sani-Cloth HB (berbahan dasar QUAT) Sani-Cloth Plus (berbahan dasar QUAT/IPA)

1. Larutan sabun lembut tidak mengandung bahan berbahaya dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Larutan tersebut tidak boleh mengandung pewangi, minyak, atau alkohol. Larutan pembersih tangan tidak sesuai untuk digunakan.



PERHATIAN

Jangan gunakan pembersih abrasif atau aseton, MEK, tiner cat, atau larutan keras lain pada sistem, perangkat, atau transduser.



PERHATIAN

Jangan gunakan Sani-Cloth AF3 atau Super Sani-Cloth untuk mendesinfeksi sistem.



PERHATIAN

Pada layar tampilan, jangan gunakan pembersih kaca atau produk yang mengandung pemutih. Segera seka disinfektan atau pembersih untuk mencegah penumpukan residu.



PERHATIAN

Jangan menumpahkan atau menyemprotkan cairan ke jahitan sistem, port, atau ke soket transduser mana pun.



PERHATIAN

Pada layar tampilan, gunakan kain mikrofiber; jangan menggunakan tissue.



PERHATIAN

Permukaan sistem dan transduser bersifat resistan terhadap gel, alkohol, dan disinfektan ultrasound, tetapi jika Anda menggunakan bahan tersebut, Anda harus menyekanya untuk mencegah kerusakan permanen.

Untuk petunjuk mengenai pembersihan dan desinfeksi sistem ultrasound dan transduser, lihat bagian *Pemeliharaan dan Pembersihan Sistem Ultrasound dan Transduser* atau situs web "Transducer and System Care":

www.philips.com/transducercare

Panduan untuk AR (Reprosesor Otomatis/Automated Reprocessors)

Hanya sebagian transduser yang kompatibel dengan reprosesor otomatis (AR), dan AR hanya dapat menggunakan larutan atau kondisi pemrosesan tertentu.

Anda dapat memproses ulang transduser Philips dalam AR, jika kriteria berikut terpenuhi:

- Semua bahan kimia dan kondisi pemrosesan yang digunakan harus sesuai dengan model transduser Philips yang diproses ulang, dan itu semua harus digunakan sesuai dengan syarat yang disarankan oleh produsen AR.
- Suhu yang digunakan selama pemrosesan ulang tidak boleh melebihi 55 °C (131 °F).
- Selain pada waktu menggunakan sistem Sterrad, konektor transduser harus terlindung dari larutan pembersih atau disinfektan selama pemrosesan ulang. Tindakan ini akan membatasi risiko percikan pada gagang atau konektor.

Berikut ini adalah AR yang memenuhi persyaratan pemrosesan ulang transduser Philips tertentu. AR ini dirancang secara khusus untuk, atau menyediakan sambungan yang mendukung, pemrosesan ulang transduser tertentu.



PERHATIAN

Reprosesor Otomatis tidak sesuai untuk penggunaan dengan transduser USB.

AR yang Kompatibel dengan Transduser Non-TEE Philips

Produsen	Negara Asal	Model	Jenis Transduser	Disinfektan yang Sesuai	Kondisi Pengoperasian
Advanced Sterilization Products	US	STERRAD 100S	L10-4lap, C9-3io	--	Hidrogen Peroksida
CIVCO Medical Solutions	US	Astra VR	Endokavitas ¹	Cidex OPA, Resert XL HLD, Metricide OPA Plus	32°C
Germitec	FR	Antigermix S1	Beberapa ²	--	UV-C
Nanosonics	AU	Trophon EPR	Beberapa ³	--	Hidrogen Peroksida

1. Mengenai transduser yang kompatibel, lihat Astra VR di [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel” pada halaman 31](#) kemudian gunakan nomor Kolom Kompatibilitas untuk merujuk ke daftar yang sesuai di [“Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan” pada halaman 27](#).
2. Mengenai transduser yang kompatibel, lihat Antigermix S1 di [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel” pada halaman 31](#) kemudian gunakan nomor Kolom Kompatibilitas untuk merujuk ke daftar yang sesuai di [“Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan” pada halaman 27](#).
3. Mengenai transduser yang kompatibel, lihat Trophon EPR di [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel” pada halaman 31](#) kemudian gunakan nomor Kolom Kompatibilitas untuk merujuk ke daftar yang sesuai di [“Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan” pada halaman 27](#).

Panduan untuk AER (Automated Endoscope Reprocessors/Reprosesor Endoskopi Otomatis)

Hanya ada sebagian transduser yang kompatibel dengan reporesor endoskopi otomatis (AER), dan AER hanya dapat menggunakan larutan tertentu.

Anda dapat memproses ulang transduser TEE Philips dalam AER, jika kriteria berikut terpenuhi:

- Semua bahan kimia dan ketentuan pemrosesan yang digunakan harus sesuai dengan model transduser TEE Philips yang diproses ulang, dan itu semua harus digunakan sesuai dengan syarat yang disarankan oleh produsen AER.
- Suhu yang digunakan selama pemrosesan ulang tidak boleh melebihi 45 °C (113 °F).
- Gagang dan konektor transduser TEE harus terlindung dari larutan pembersih atau disinfektan selama pemrosesan ulang, termasuk sandaran gagang dan mekanisme penyegelan. Tindakan ini akan membatasi risiko percikan pada gagang atau konektor.
- Selama penggunaan AER, dilarang menggunakan pembatas atau perangkat protektif yang ditujukan untuk melindungi gagang dan konektor sehingga memungkinkan seluruh transduser tercelup atau terkena larutan disinfektan sepenuhnya.
- Metode pengeringan yang dipanaskan tidak boleh digunakan.

Berikut ini adalah contoh AER yang memenuhi persyaratan pemrosesan ulang transduser TEE Philips. AER ini secara khusus didesain untuk, atau menyediakan sambungan yang mendukung, pemrosesan ulang transduser.

Contoh: AER yang Kompatibel Dengan Transduser TEE Philips

Produsen	Negara Asal	Model	Jenis Transduser	Disinfektan yang Sesuai	Suhu Pengoperasian
CIVCO Medical Solutions	US	Astra TEE	TEE	Cidex OPA, MetriCide OPA Plus, Resert XL HLD	40°C (104°F)
CS Medical	US	TD-100	TEE	TD-5, TD-8	37 °C (98,6 °F)

Produsen	Negara Asal	Model	Jenis Transduser	Disinfektan yang Sesuai	Suhu Pengoperasian
Germitec	FR	Antigermix E1	TEE	--	UV-C
Medivators	US	Sistem Advantage Plus Endoscope Reprocessing	TEE	Rapicide PA	30 °C (86 °F)
Soluscope	FR	Serie TEE	TEE	Soluscope P/ Soluscope A, Proxy P/Proxy A	40°C (104°F)

Untuk petunjuk pembersihan dan desinfeksi transduser TEE dengan AER, lihat bagian *Pemeliharaan dan Pembersihan Sistem Ultrasound dan Transduser*.

Disinfektan dan Larutan Pembersih untuk Transduser

Bagian berikut mencakup tiga tabel yang memberi tahu Anda mengenai disinfektan dan larutan pembersih yang tersedia untuk sistem transduser Anda.

- [“Kompatibilitas Disinfektan menurut Nama Transduser”](#) pada halaman 22: Mencantumkan transduser sesuai urutan dengan referensi kompatibilitas disinfektan dan larutan pembersihnya. Temukan transduser Anda di kolom Nama Transduser, kemudian lihat referensi kolom Kompatibilitas untuk kolom Kompatibilitas yang tepat dari [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel”](#) pada halaman 31.
- [“Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan”](#) pada halaman 27: Menyusun transduser sesuai kolom Kompatibilitas terkait dari [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel”](#) pada halaman 31. Gunakan tabel ini untuk segera memahami transduser mana yang sesuai dengan kolom Kompatibilitas bernomor.

- [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel” pada halaman 31](#): Mencantumkan daftar disinfektan dan larutan pembersih yang kompatibel dengan transduser Philips. Kolom Kompatibilitas bernomor mengindikasikan kompatibilitas disinfektan dan larutan pembersih dengan transduser terkait. Gunakan salah satu dari dua tabel transduser berikut untuk menentukan kolom Kompatibilitas mana yang sesuai dengan transduser Anda.

Kompatibilitas Disinfektan menurut Nama Transduser

Tabel ini mencantumkan transduser sesuai urutan dengan kombinasi angka dan huruf, berdasarkan referensi kompatibilitas disinfektan dan larutan pembersihnya. Temukan transduser (dan sistem, jika ditentukan) Anda pada kolom Nama Transduser, kemudian lihat Kolom Kompatibilitas untuk mengenali kolom Kompatibilitas yang berlaku dari [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel” pada halaman 31](#). Jika sistem tidak ditentukan, semua versi dari transduser menggunakan kolom Kompatibilitas yang sama.

Untuk daftar transduser yang didukung oleh sistem Anda, lihat *Panduan Pengguna* sistem Anda.

Referensi Kompatibilitas berdasarkan Nama Transduser

Nama Transduser (Nama Sistem)	Kolom Kompatibilitas
1.9MHz CW Pencil	3
1.9MHz TCD	3
3D6-2	1
3D8-4	1
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	1
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	2
5.0MHz CW Pencil	3
7.5MHz Endo	1
BP10-5ec	2
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	1

Nama Transduser (Nama Sistem)	Kolom Kompatibilitas
C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)	2
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	1
C5-2 (ClearVue)	2
C5-2 (Lumify, Xperius)	8
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	1
C6-2 Compact (Affiniti)	2
C6-3	1
C8-4v	1 atau 2 [†]
C8-5	1
C8-5 Compact (CX30, CX50)	1
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
C9-2	2
C9-3io	7
C9-3v	2
C9-4	1
C9-4ec	1
C9-4v	2
C9-4v Compact	2
C9-5ec	1
C10-3v	2
C10-4ec	2
D2cwc	3

Nama Transduser (Nama Sistem)	Kolom Kompatibilitas
D2tcd	3
D5cwc	3
eL18-4	2
L8-4	1
L9-3	1
L10-4lap	6
L11-3	1
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	2
L12-4 (ClearVue)	2
L12-4 (Lumify, Xperius)	8
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	1
L12-4 Compact (Affiniti)	2
L12-5 38 mm	1
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)	1
L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)	2
L12-5 50 mm	1
L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22)	1 atau 2 †
L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)	2
L17-5	1
L18-5	2
OMNI III TEE	5

Nama Transduser (Nama Sistem)	Kolom Kompatibilitas
S3-1	1
S4-1 (iU22)	1
S4-1 (ClearVue)	2
S4-1 (Lumify)	8
S4-2	1
S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)	1
S4-2 Compact (Affiniti)	2
S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)	1
S5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
S5-2	1
S6-2mpt	5
S7-2t	5
S7-3t	4
S8	1
S8-3	1
S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)	1
S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
S8-3t	4
S9-2	2
S12	1
S12-4	1
S12-4 Compact (CX50)	1

Nama Transduser (Nama Sistem)	Kolom Kompatibilitas
S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)	2
DTK	3
V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)	1
V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)	2
V8-4	1
VL13-5	1
VL13-5 Compact	2
X3-1	1
X5-1 (iE33)	1
X5-1 (Affiniti, EPIQ)	2
X6-1	2
X7-2 (iE33, iU22)	1
X7-2 (EPIQ)	2
X7-2t	5
X8-2t	5
X8-2ti	5

Catatan Kaki

†	<p>Gunakan Kolom Kompatibilitas 2 untuk model C8-4v dengan nomor bagian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor bagian 4535611 7292x, dengan x adalah 3 atau lebih • Nomor bagian 4535612 8750x, dengan x adalah 2 atau lebih • Nomor bagian 4535613 1895x, dengan x adalah 1 atau lebih • Nomor bagian 4535614 9748x, dengan x adalah 1 atau lebih • Nomor bagian 4535614 9749x, dengan x adalah 1 atau lebih • Nomor bagian 4535616 8452x dengan x adalah 1 atau lebih <p>Gunakan Kolom Kompatibilitas 1 untuk model C8-4v dengan nomor bagian lain.</p> <p>Untuk menemukan nomor bagian, lihat bagian dalam rumah konektor.</p>
‡	<p>Gunakan Kolom Kompatibilitas 2 untuk model L15-7io dengan nomor bagian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nomor bagian 4535614 0781x, dengan x adalah 1 atau lebih • Nomor bagian 4535612 8750x, dengan x adalah 2 atau lebih <p>Gunakan Kolom Kompatibilitas 1 untuk model L15-7io dengan nomor bagian lain.</p> <p>Untuk menemukan nomor bagian, lihat bagian dalam rumah konektor.</p>

Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan

Tabel ini menyusun transduser berdasarkan kolom Kompatibilitas terkait dari [“Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel” pada halaman 31](#). Warna pada judul kolom juga menyesuaikan warna kolom Kompatibilitas. Jika sistem tidak ditentukan, semua versi dari transduser menggunakan kolom Kompatibilitas yang sama.

Untuk daftar transduser yang didukung oleh sistem Anda, lihat *Panduan Pengguna* sistem Anda.

Daftar Transduser berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan

Transduser (Nama Sistem) Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 1

3D6-2

L12-5 50 mm

3D8-4	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
3D9-3v (HD11, HD15, iU22)	L17-5
7.5MHZ Endo	S3-1
C5-1 (CX50, HD15, iE33, iU22)	S4-1 (iU22)
C5-2 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15, iE33, iU22)	S4-2
C6-2 Compact (CX30, Sparq)	S4-2 Compact (CX30, CX50, Sparq)
C6-3	S5-1 (CX50, iE33, iU22, Sparq)
C8-4v ¹	S5-2
C8-5	S8
C8-5 Compact (CX30, CX50)	S8-3
C9-4	S8-3 Compact (CX30, CX50, HD5)
C9-4ec	S12
C9-5ec	S12-4
L8-4	S12-4 Compact (CX50)
L9-3	V6-2 (HD11 XE, HD15, iU22)
L11-3	V8-4
L12-3 (HD5, HD6, HD7, HD11, HD15)	VL13-5
L12-4 Compact (CX30, Sparq)	X3-1
L12-5 38 mm	X5-1 (iE33)
L12-5 50 mm Compact (CX50, Sparq)	X7-2 (iE33, iU22)
Transduser (Nama Sistem) Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 2	
3D9-3v (Affiniti, ClearVue, EPIQ)	L12-4 Compact (Affiniti)
BP10-5ec	L12-5 50 mm Compact (Affiniti, EPIQ)

C5-1 (Affiniti, EPIQ, Sparq)	L15-7io (Affiniti, CX30, CX50, EPIQ, Sparq)
C5-2 (ClearVue)	L15-7io (HD11, HD15, iE33, iU22) ²
C6-2 Compact (Affiniti)	L18-5
C8-4v ¹	S4-1 (ClearVue)
C8-5 Compact (Affiniti, EPIQ)	S4-2 Compact (Affiniti)
C9-2	S5-1 (Affiniti, EPIQ)
C9-3v	S8-3 Compact (Affiniti, EPIQ)
C9-4v	S9-2
C9-4v Compact	S12-4 Compact (Affiniti, EPIQ)
C10-3v	V6-2 (Affiniti, ClearVue, EPIQ, HD5)
C10-4ec	X5-1 (Affiniti, EPIQ)
eL18-4	X6-1
L12-3 (Affiniti, CX50, EPIQ)	X7-2 (EPIQ)
L12-4 (ClearVue)	
Transduser yang Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 3	
1.9MHz CW Pencil	
1.9MHz TCD	
5.0MHz CW Pencil	
D2cwc	
D2tcd	
D5cwc	
DTK	
Transduser yang Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 4	

S7-3t

S8-3t

Transduser yang Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 5

OMNI III TEE

S6-2mpt

S7-2t

X7-2t

X8-2t

X8-2ti

Transduser yang Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 6

L10-4lap

Transduser yang Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 7

C9-3io

Transduser yang Tercakup oleh Kolom Kompatibilitas 8

C5-2 (Lumify, Xperius)

L12-4 (Lumify, Xperius)

S4-1 (Lumify)

Catatan Kaki

-
- 1 Gunakan Kolom Kompatibilitas 2 untuk model C8-4v dengan nomor bagian berikut:
- Nomor bagian 4535611 7292x, dengan x adalah 3 atau lebih
 - Nomor bagian 4535612 8750x, dengan x adalah 2 atau lebih
 - Nomor bagian 4535613 1895x, dengan x adalah 1 atau lebih
 - Nomor bagian 4535614 9748x, dengan x adalah 1 atau lebih
 - Nomor bagian 4535614 9749x, dengan x adalah 1 atau lebih
 - Nomor bagian 4535616 8452x dengan x adalah 1 atau lebih
- Gunakan Kolom Kompatibilitas 1 untuk model C8-4v dengan nomor bagian lain.
Untuk menemukan nomor bagian, lihat bagian dalam rumah konektor.
-
- 2 Gunakan Kolom Kompatibilitas 2 untuk model L15-7io dengan nomor bagian berikut:
- Nomor bagian 4535614 0781x, dengan x adalah 1 atau lebih
 - Nomor bagian 4535612 8750x, dengan x adalah 2 atau lebih
- Gunakan Kolom Kompatibilitas 1 untuk model L15-7io dengan nomor bagian lain.
Untuk menemukan nomor bagian, lihat bagian dalam rumah konektor.
-

Disinfektan dan Larutan Pembersih yang Kompatibel

Tabel berikut mencantumkan disinfektan dan larutan pembersih yang kompatibel dengan transduser yang tersedia untuk sistem ultrasound Philips Anda. Gunakan tabel pada [“Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan” pada halaman 27](#) atau [“Kompatibilitas Disinfektan menurut Nama Transduser” pada halaman 22](#) untuk menemukan transduser dan kolom Kompatibilitas yang sesuai.



PERHATIAN

Penggunaan isopropil alkohol (alkohol gosok), denaturasi etil alkohol, dan produk berbahan dasar alkohol pada semua transduser dibatasi. Pada transduser dengan konektor USB, bagian yang boleh dibersihkan dengan alkohol hanyalah rumah dan lensa (jendela akustik) transduser. Pada transduser non-TEE, bagian yang boleh dibersihkan dengan alkohol hanyalah rumah konektor dan rumah transduser dan lensa. Pada transduser TEE, bagian yang dapat dibersihkan dengan alkohol hanyalah rumah konektor dan rumah kontrol. Pastikan larutan hanya isopropil alkohol 91% atau kurang, atau denaturasi etil alkohol 85% atau kurang. Jangan bersihkan bagian lain dari transduser dengan alkohol (termasuk kabel, konektor USB, atau pelepas tegangan), karena dapat merusak bagian transduser tersebut. Kerusakan ini tidak tercakup dalam jaminan atau kontrak layanan Anda.

Berdasarkan pengujian kompatibilitas bahan, profil penggunaan produk, dan bahan aktif, Philips telah secara umum menyetujui penggunaan jenis disinfektan *tingkat rendah* berikut untuk digunakan sebagai penyemprot atau penyeka permukaan (kontak dengan kulit) dan transduser transvaginal atau transrektal, sesuai dengan batasan kompatibilitas dalam tabel disinfektan. Persetujuan ini tidak berlaku untuk transduser transesofageal atau laparoskopi.


- Berbahan dasar natrium hipoklorit (contohnya, larutan pemutih rumah tangga 10% dengan natrium hipoklorit aktif sekitar 0,6%)
- Berbahan dasar amonium kuarterner (QUAT) (contohnya, produk yang mengandung larutan n-alkil xbenzil amonium klorida dengan x dapat berupa gugus fungsional organik seperti etil dan metil, dan lain-lain; konsentrasi penggunaan harus kurang dari 0,8% total untuk semua QUAT yang dicantumkan)
- Berbahan dasar hidrogen peroksida terakselerasi (hidrogen peroksida maksimal 0,5%)
- Berbahan dasar alkohol atau alkohol plus QUAT (kandungan alkohol dalam produk tidak boleh melebihi isopropil alkohol 91% atau denaturasi etil alkohol 85%)
- Produk yang tidak dicantumkan secara khusus dalam tabel kompatibilitas tetapi memiliki bahan aktif yang sama seperti yang ditunjukkan pada daftar ini, serta dijual untuk penggunaan medis.

Selalu ikuti petunjuk produsen saat menggunakan disinfektan dan larutan pembersih.

Karena banyak sekali produk pembersih dan disinfeksi yang tersedia, tidak mungkin untuk mencantumkan semuanya di dalam tabel. Jika Anda tidak yakin bahwa suatu produk sesuai untuk digunakan, harap hubungi perwakilan Philips untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.


Tanda Keterangan Tabel Larutan Disinfektan dan Pembersih

Negara Asal	Jenis Disinfektan	Kompatibilitas
AU = Australia	CL = Cleaner (Pembersih)	C = Disetujui untuk digunakan pada kabel dan konektor (jangan pernah mencelupkan atau merendam konektor)
CA = Kanada	HLD = High-level disinfectant (Disinfektan tingkat tinggi)	H = Disetujui untuk digunakan pada gagang dan mekanisme setir
DE = Jerman	ILD = Intermediate-level disinfectant (Disinfektan tingkat sedang)	N = Tidak disetujui untuk digunakan
ES = Spanyol	LLD = Low-level disinfectant (Disinfektan tingkat rendah)	T = Disetujui untuk digunakan pada transduser
FR = Prancis	S = Sterilant (Sterilan)	
JP = Jepang		
UK = Inggris		
US = Amerika Serikat		

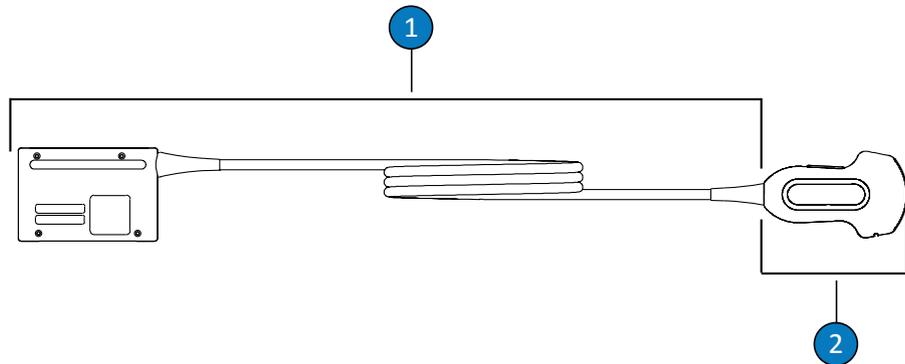


Komponen Transduser Non-TEE

- 1 C (Kabel dan konektor)
- 2 T (Transduser)

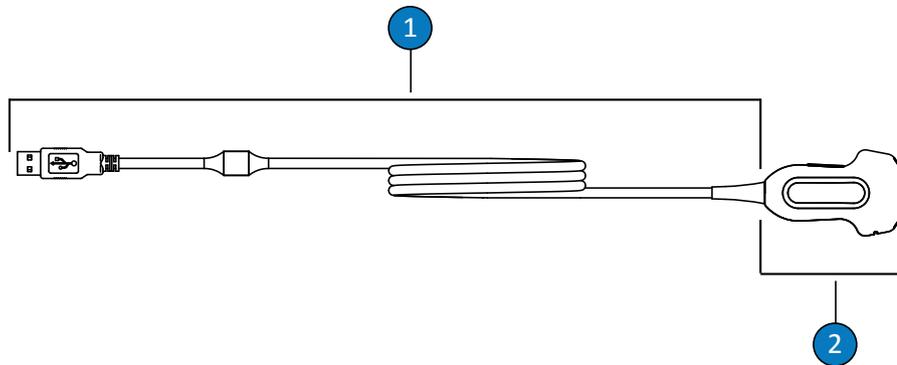

Transduser Non-TEE (Koneksi USB)

- 1 C (Kabel dan konektor)
- 2 T (Transduser)

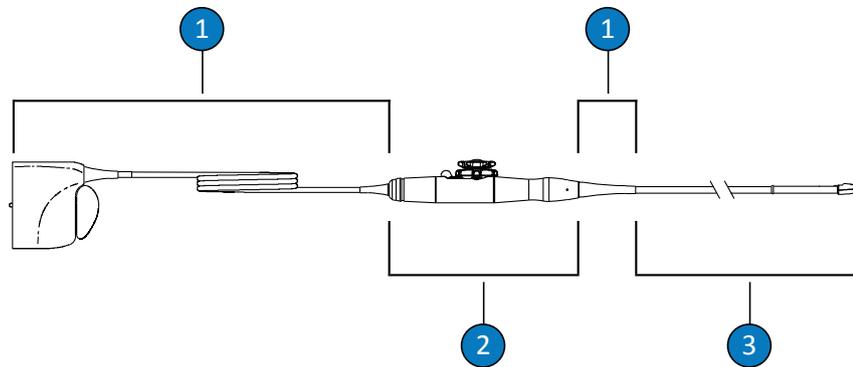

Komponen Transduser TEE

- 1 C (Kabel, konektor, dan strain relief)
- 2 H (Gagang dan mekanisme setir)
- 3 T (Transduser dan poros fleksibel)

CATATAN

Gunakan tabel dalam “Daftar Transduser Berdasarkan Kompatibilitas Disinfektan” pada halaman 27 atau “Kompatibilitas Disinfektan menurut Nama Transduser” pada halaman 22 untuk menemukan transduser dan Kolom Kompatibilitas yang sesuai.

Kompatibilitas Disinfektan dan Larutan Pembersih

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Accel Wipes (semua jenis)	CA	Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Acecide	JP	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD, S	N	N	N	N	T	N	N	N
Advantage Plus	US	AER	Rapicide PA	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
Aidal Plus	AU	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Alkaspray	FR	Semprot/Seka	Alkohol, Alkilamina	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Anios Clean Excel D	FR	Semprot/Seka/ Celup ¹	QUAT, Klorheksidin glukonat, Surfaktan	CL	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Aniosept Activ	FR	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD, S	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
ANIOXY DM	FR	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD, S	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Anioxyde 1000	FR	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Antigermix E1	FR	Sistem Antigermix E1	UV-C	HLD	N	N	N	T,C,H ₅	T,C,H ₅	N	N	N

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Antigermix S1	FR	Sistem Antigermix S1	UV-C	HLD	T,C ²	T,C ²	N	N	N	N	T,C	N
ASTRA TEE	US	AER	Bergantung pada larutan	HLD	Lihat larutan spesifik yang digunakan dengan reprosesor endoskopi otomatis ini (Cidex OPA, Metricide OPA, Resert XL)							
ASTRA VR	US	AR	Bergantung pada larutan	HLD	Lihat larutan spesifik yang digunakan dengan reprosesor otomatis ini (Cidex OPA, Metricide OPA, Resert XL)							N
Bacillol 30 Foam	DE	Semprot/Seka	Alkohol, Alkilamina	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Banicide Plus	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Pemutih (0,6% NaOCl Max)	Semua	Semprot/Seka	Natrium Hipoklorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
CaviWipes	US	Seka	Alkohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Cidex	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cidex 7	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cidex OPA	US	Celup ¹	Orto-ftalaldehida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cidex Plus	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Cleanisept Wipes	DE	Semprot/Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Clinell Sporicidal Wipes	UK	Seka	Asam Perasetat, Surfaktan	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Tisu Sanitasi Universal Clinell	UK	Semprot/Seka	QUAT, Biguanida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Pembersih Clorox Healthcare Bleach Germicidal	US	Semprot/Seka	Natrium Hipoklorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Disinfektan Pembersih Peroksida Hidrogen Clorox Healthcare	US	Semprot/Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Combi- Instruments-N	DE	Celup ¹	Campuran glutaraldehid & formasetal	HLD	T,C	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Etil Alkohol Terdenaturasi (maksimum 85%)	Semua	Semprot/Seka	Etil Alkohol Terdenaturasi, Air	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Descoton Extra	DE	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Dispatch	US	Semprot/Seka	Natrium Hipoklorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Endosporine	FR	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Enzol	US	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	CL	T,C	T,C	N	T	T,C,H	T,C,H	T,C	T

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Epizyme Rapid	AU	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	CL	T,C	T,C	N	T	T,C,H	T,C,H	T,C	T
Gigasept FF (baru)	DE	Celup ¹	Suksinat dialdehid	HLD	T,C	T,C	N	T	T	N	T,C	T
Gigasept PA	DE	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Gigasept PAA Concentrate	DE	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Hexanios G+R	FR	Celup ¹	QUAT, Biguanida, Surfaktan	Pembersih, LLD, ILD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T
Hibiclens (4% Maks)	US	Pembersih awal	Klorheksidin glukonat	CL	T,C	T,C	T	T,C	T,C	T,C	T,C	T,C
Incidin	DE	Semprot/Seka	Alkohol	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Incidin OxyWipe	DE	Semprot/Seka	Hidrogen Peroksida, Surfaktan	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyWipe (S)	DE	Semprot/Seka	Hidrogen Peroksida, Surfaktan	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam	DE	Semprot/Seka	Hidrogen Peroksida, Surfaktan	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin OxyFoam (S)	DE	Semprot/Seka	Hidrogen Peroksida, Surfaktan	CL, LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Incidin Plus	DE	Celup ¹	Glukoprotamina	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Incidin Rapid	DE	Semprot/Seka	QUAT, Glutaraldehid	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T	T	T	T,C	T,C
Incidur Spray	DE	Semprot/Seka	Alkohol, QUAT, Aldehida	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Instruzyme	FR	Pembersih awal	Enzim, QUAT, Biguanida	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Isopropil Alkohol (maksimum 91%)	Semua	Semprot/Seka	Isopropil Alkohol, Air	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Klenzyme	US	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Korsolex Basic	FR	Celup ¹	Pelepasan Aldehida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T	T
Korsolex Extra	FR	Celup ¹	QUAT, Aldehida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Korsolex PAE	FR	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Penghilang Biofilm Matriks	AU	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	CL	T,C	T,C	T	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
MaxiCide Plus	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MedDis	UK	Celup ¹	QUAT, Asam Sulfamat	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Medistel	UK	Celup ¹	QUAT, Asam Sulfamat	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Medizyme	AU	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
MetriCide	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriCide 28	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriCide OPA Plus	US	Celup ¹	Orto-ftalaldehida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriCide Plus 30	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
MetriZyme	US	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Jaringan Virusidal Mikroba	DE	Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
seka mikrozid PAA	DE	Seka	Asam Perasetat	LLD, ILD	N	T,C	T,C	N	T,C	T,C,H	T,C	T,C
Larutan Sabun Lembut ⁴	Semua	Pembersih awal	Surfaktan	CL	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Milton	AU	Semprot/Seka	Natrium Hipoklorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
NDP Med Concentrated Plus	ES	Celup ¹	N-Duopropenida, Alkilamin	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
neodisher endo CLEAN/ neodisher endo SEPT PAC	DE	AER	Surfaktan, Asam Perasetat	CL, HLD	N	N	N	N	T	N	N	N

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
neodisher endo DIS aktif	DE	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T
neodisher Septo Aktif	DE	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Asam Perasetat Olympic	UK	AER	Asam Perasetat	HLD	N	N	N	N	T	T	T,C	N
Omnicide 14NS	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Omnicide 28	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
OPAL	AU	Celup ¹	Orto-ftalaldehida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Opti-Cide3	US	Semprot/Seka	Alkohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Oxivir (semua jenis)	US	Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Oxygenon-I	DE	Celup ¹	Pembuatan Oksigen	HLD	N	T,C	N	T ³	T	T	T,C	T
PeraSafe	UK	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD, S	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Perascope	UK	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
Perastel	UK	AER / Rendam ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	N	T	T	T,C	T
PerCept (semua jenis)	CA	Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Phagocide D	FR	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Phagozyme ND	FR	Pembersih awal	Enzim, QUAT	CL	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
PI-Spray (Awalnya T-Spray)	US	Semprot/Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PI-Spray II (Awalnya T- Spray II)	US	Semprot/Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Konsentrat PREempt	CA	Semprot/Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PREempt RTU	CA	Semprot/Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
PREempt Wipes	CA	Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
ProCide-D	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
ProCide-D Plus	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Prolystica 2X	US	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	CL	T,C	T,C	N	T,C,H	T,C,H	T	T,C	T
Protex Disinfectant (Semua Tipe)	US	Semprot/Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Proxy P/Proxy A	AU	Serie TEE AER	Asam Perasetat	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Amonium Kuarternar (Maks. 0,8% Aktif)	Semua	Semprot/Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Rapicide	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Rapicide OPA	US	Celup ¹	Orto-ftalaldehida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Rapicide PA	US	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	N
Revital-Ox Resert XL HLD	US	Celup ¹	Hidrogen Peroksida	HLD	T,C	T,C	N	T ³	T	T	N	T
Rivascop	FR	Semprot/Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Salvanios pH 10	FR	Semprot/Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Active	DE	Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF	US	Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth AF3	US	Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Bleach	US	Seka	Natrium Hipoklorit	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	C	C	C	T,C	T,C
Sani-Cloth CHG 2%	UK	Semprot/Seka	Alkohol, Klorheksidin glukonat	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sani-Cloth HB	US	Seka	QUAT	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Sani-Cloth Plus	US	Seka	Alkohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Sekucid N	FR	Celup ¹	Glutaraldehyd	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Sekusept Aktiv	DE	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Sekusept Easy	DE	Celup ¹	Asam Perasetat	HLD	N	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Sekusept Plus	DE	Celup ¹	Glukoprotamina	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Soluscope P/ Soluscope A	FR	Serie TEE AER	Asam Perasetat	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Steranios 2%	FR	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Sterrad 100S	US	Reprosesor (S)	Hidrogen Peroksida	S	N	N	N	N	N	T,C,H	T,C	N
Super Sani-Cloth	US	Seka	Alkohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
TD-5	US	Reprosesor TD-100	Glutaraldehid	HLD	N	N	N	T	T	N	N	N
TD-8	US	Reprosesor TD-100	Orto-ftalaldehida	HLD	N	N	N	N	T	N	N	N
Spons Enzimatik Zyme TEE	US	Pembersih awal	Enzim, Surfaktan	Cleaner (Pembersih)	N	N	N	T,C,H	T,C,H	N	N	N
Tristel Duo	UK	Seka	Klorin Dioksida	HLD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	T,C
Tristel Fuse untuk Stella	UK	Sistem Stella	Klorin Dioksida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T	T
Tristel Multi- Shot	UK	Celup ¹	Klorin Dioksida	HLD	T,C	T,C	N	T	T	T	T	T
Tristel Sporicidal Wipes	UK	Seka	Klorin Dioksida	HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C
Tristel Trio Wipes / Tristel Trio Trace	UK	Seka pembersih awal, Sporisidal, Pembilas	Enzim, Surfaktan, Klorin Dioksida	CL, HLD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T

Larutan/ Sistem	Negara Asal	Aturan Penggunaan	Bahan Aktif	Jenis Disinfektan	Kolom Kompatibilitas							
					1	2	3	4	5	6	7	8
Trophon EPR	AU	Reprosesor Trophon EPR	Hidrogen Peroksida	HLD	T,C	T,C	N	N	N	N	T,C	N
Vaposeptol	FR	Semprot/Seka	Alkohol, Biguanida	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T
Virox 5 RTU	CA	Seka	Hidrogen Peroksida	LLD, ILD	T,C	T,C	T,C	T,C,H	T,C,H	T,C,H	T,C	T,C
Wavicide -01	US	Celup ¹	Glutaraldehid	HLD, S	T,C	T,C	N	T	T	T	T,C	T
Wip'Anios	FR	Seka	Alkohol, QUAT	LLD, ILD	T	T	T	H	H	T,H	T	T

1. Jangan pernah mencelupkan atau merendam konektor. Produk ini dapat digunakan dalam reporesor endoskopi otomatis (AER) sesuai dengan prosedur dalam dokumen *Pemeliharaan dan Pembersihan Sistem Ultrasound dan Transduser*.
2. Antigermix S1 tidak diperbolehkan untuk 3D6-2, 3D8-4, V6-2, V8-4, VL13-5, atau VL13-5 Compact.
3. Oxygenon-I dan Revital-Ox Resert XL HLD dapat menghasilkan sedikit perubahan warna pada poros fleksibel dari transduser S7-3t dan S8-3t. Perubahan warna ini tidak berpengaruh pada keamanan atau performa perangkat.
4. Larutan sabun lembut tidak mengandung bahan berbahaya dan tidak menimbulkan iritasi pada kulit. Larutan tersebut tidak boleh mengandung pewangi, minyak, atau alkohol. Larutan pembersih tangan tidak sesuai untuk digunakan.
5. Antigermix E1 dapat mengubah warna bagian plastik transduser transesofageal.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431
USA



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 4-6
5684 PC Best
The Netherlands

CE 0086



© 2018 Koninklijke Philips N.V.

Semua hak dilindungi undang-undang. Memperbanyak atau mengirimkan secara keseluruhan atau sebagian dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, elektronik, mekanis, atau selain itu dilarang tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemilik hak cipta.

Diterbitkan di Amerika Serikat
4535 619 59791_A/795 * APR 2018 - id-ID